


疲劳测试：对比研究法

下图四个点表示用规格CN21， M30NW™ 和规格Rex734™的中空医疗棒材所做的疲劳测试，与相似对应规格的钻孔产品所做的测试进行比较。

实验：

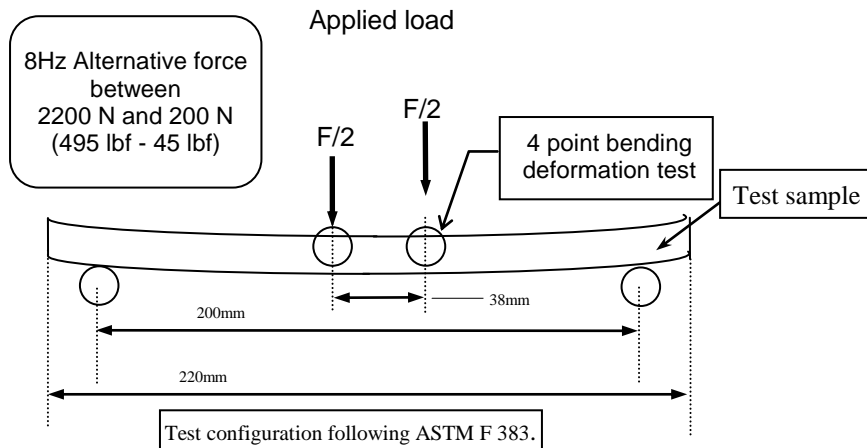

结果：

Sample N°	Cycles to failure	
	同类钻孔产品	福雷孔中空材
1	62.948	60.650
2	65.446	69.110
3	87.786	60.022
4	54.949	
平均值	67.782	63.260
标准偏差	14.067	5.075